



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ УКРАИНЫ ПО ВОПРОСАМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ПОЛИТИКИ

Серия Г

№ 005294



СЕРТИФИКАТ
соответствия средств измерительной техники
утвержденному типу

№ UA-MI/2p-2883-2009


Выдан 26 мая 2009 г.

Настоящий сертификат подтверждает, что идентифицированные должным образом анализаторы жидкости кондуктометрические КВЧ 5М, код УКТ ВЭД 9027 80 11 90, которые серийно изготавливаются фирмой "Инженерный центр приборостроения и компьютеризации" в форме общества с ограниченной ответственностью, г. Харьков, соответствуют утвержденному типу, зарегистрированному в Государственном реестре средств измерительной техники под номером У62-09, а также требованиям ГОСТ 13350-78, ТУ У 33.2-14082639-001:2008.

Сертификат выдан изготовителю решением Научно-технической комиссии по метрологии Государственного комитета Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики на основании положительных результатов государственных контрольных испытаний, проведенных ГП "Харківстандартметрологія" (акт испытаний от 7 апреля 2009 г.).

Изготовитель обязан обеспечить соответствие анализаторов жидкости кондуктометрических КВЧ 5М утвержденному типу и требованиям нормативных документов, указанных в настоящем сертификате, с учетом гарантийных сроков изготовителя на конкретный образец средств измерительной техники.

Заместитель Председателя

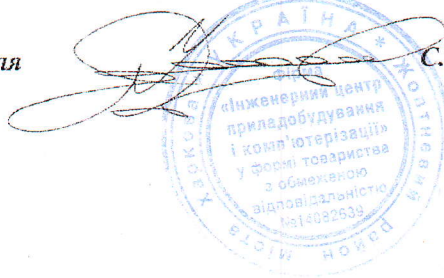

С.Т. Черепков



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ УКРАИНЫ ПО ВОПРОСАМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ПОЛИТИКИ

Серия Б

№ 005404



СЕРТИФИКАТ

утверждения типа средств измерительной техники

№ UA-MI/1p-930-2009

Выдан 26 мая 2009 г.

Настоящий сертификат, выданный фирме "Инженерный центр приборостроения и компьютеризации" в форме общества с ограниченной ответственностью, г. Харьков, удостоверяет, что на основании положительных результатов государственных контрольных испытаний Государственным комитетом Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики утвержден тип средств измерительной техники "Анализаторы жидкости кондуктометрические КВЧ 5М", зарегистрированный в Государственном реестре средств измерительной техники под номером У62-09.

Анализаторы жидкости кондуктометрические КВЧ 5М при выпуске из производства подлежат поверке.

Межповерочный интервал, установленный при утверждении типа анализаторов, — не более одного года, рекомендуемый межкалибровочный интервал — 1 год.

Заместитель Председателя



С.Т. Черепков